

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2026

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa, sản khoa. Với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

2. Mọi thông tin cần liên hệ về báo giá: + số 024 38711751

+ số 0914864168 để được hỗ trợ.

3. Cách thức nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư - Tầng 1 nhà A, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

- Nhận qua email: + [bvdkdg@hanoi.gov.vn](mailto:bvdkdg@hanoi.gov.vn)

+ [Cuongvu.ducgiang@gmail.com](mailto:Cuongvu.ducgiang@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08h ngày 11 tháng 5 năm 2026 đến trước 17h ngày 21 tháng 5 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2026

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục bảo dưỡng:

TT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả yêu cầu về yêu cầu kỹ thuật
1	-Sửa chữa hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa, sản khoa -Hãng sx: KARL STORZ -Nước sản xuất:Đức -Nội dung sửa chữa: Thay màn hình nội soi	Cái	01	<ul style="list-style-type: none"><li>Màn hình phẫu thuật 24 inches</li><li>Có chức năng ổn định đèn nền để giữ độ sáng ổn định trong suốt vòng đời của màn hình.</li><li>Chuẩn DICOM cho phép màn hình hiển thị hình ảnh PACS trong phòng mổ</li><li>Có chế độ hiển thị hình ảnh/video từ các thiết bị khác đồng thời khi thực hiện phẫu thuật.</li><li>Có thể điều chỉnh được nhiệt độ màu: Thấp nhất 5500K, cao nhất 10.000K</li><li>Tỷ lệ khung hình tối thiểu có: 5:4/ 4:3/ Full/ Full</li></ul>



			<p>Aspect</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Có chế độ: PIP/ Side-by-side</li> <li>▪ Kích thước màn hình: 24 inches</li> <li>▪ Màn hình LCD TFT màu, chống chói, có lớp phủ cứng</li> <li>▪ Độ phân giải tối đa: 1920 x 1200</li> <li>▪ Màu sắc: 16.7 triệu màu.</li> <li>▪ Điểm ảnh: 0.270 x 0.270 mm</li> <li>▪ Độ sáng đèn nền: 600 cd/m2</li> <li>▪ Đèn nền: LED</li> <li>▪ Tuổi thọ của đèn nền tối thiểu: 50.000 giờ</li> <li>▪ Độ tương phản: 1000:1</li> <li>▪ Góc nhìn: L/R 178°, U/D 178° (CR&gt;10) Typ.</li> <li>▪ Độ trễ: 14ms</li> <li>▪ Điều chỉnh các thông số: bằng phím cảm ứng</li> <li>▪ Có chức năng khóa phím điều chỉnh các thông số.</li> <li>▪ Tín hiệu đầu vào tối thiểu có các cổng: DVI-D, VGA, RGBS, S-video</li> <li>▪ Có cổng service sửa chữa: RJ11</li> <li>▪ Tiêu chuẩn tối thiểu: IEC60601-1 và EN60601-1</li> <li>▪ Tiêu chuẩn chống bụi, nước tối thiểu: IP20</li> <li>▪ Hàng mới 100%</li> <li>▪ Bảo hành ≥ 12 tháng</li> <li>▪ Sản xuất năm 2025 trở về sau</li> </ul>
--	--	--	---

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản tại Bệnh Viện Đa Khoa Đức Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 30 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán chuyển khoản sau khi thực hiện đầy đủ hợp đồng và hồ sơ hợp lệ.


5. Các thông tin khác (nếu có): Tương thích với thiết bị của bệnh viện. Bảo hành ≥ 12 tháng, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của thiết bị. Giá báo đã bao gồm thuế, các loại phí.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VTTB.

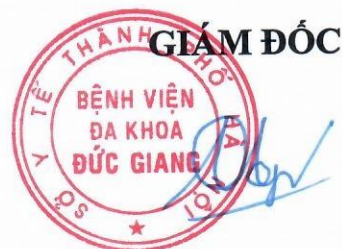

**Đỗ Đình Tùng**